

Software DWOS

Software CAD/CAM dental

Instrucciones de uso

Instrucciones de uso traducidas



DWOS

DWOS Easy

DWOS Chairside

ÍNDICE

1. Acerca de esta guía	3
1.1 Limitación de responsabilidad	3
1.2 Licencia, marcas comerciales y otros derechos	4
2. Introducción y descripción general	6
2.1 Uso previsto	6
2.2 Descripción y características del dispositivo	6
2.3 Accesorios y productos utilizados en combinación	7
2.4 Indicaciones	8
2.5 Contraindicaciones	8
2.6 Precauciones	8
2.7 Información sobre compatibilidad	9
2.8 Protección de datos	10
2.9 Copia de seguridad de datos	11
2.10 Información adicional	11
2.11 Desecho	12
3. Instalación de Software DWOS	13
4. Principios básicos e interfaz de usuario	15
4.1 Nociones básicas	15
4.2 Inicio del software	15
4.3 Interfaz de usuario	16
4.4 Diseño de restauraciones	19
5. Instrucciones paso a paso	21
5.1 Caso de ejemplo en DWOS	22
5.2 Caso de ejemplo en DWOS Chairside	26
5.3 Caso de ejemplo en DWOS Easy	29
6. Mantenimiento	38
7. Distribuidores y servicio	39
8. Datos técnicos y etiqueta	40
8.1 Especificaciones de hardware y software recomendadas	40
8.2 Hardware y software opcionales	41
8.3 Puertos usados en la instalación del software	41
8.4 Configuración y accesorios	44
8.5 Etiqueta	48
9. Explicación de los símbolos	50

1. Acerca de esta guía

En esta guía, el término Software DWOS hace referencia al software CAD/CAM dental DWOS, DWOS Easy y DWOS Chairside.

Las presentes **Instrucciones de uso** tendrán vigencia durante el *Ciclo de vida del producto (p.4)* de su software DWOS, a menos que se publique un nuevo manual en este periodo.

Las presentes **Instrucciones de uso** contienen información importante para el uso seguro y adecuado del software DWOS. Asegúrese de haber leído y entendido este documento antes de trabajar con el software. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor local. Guarde este documento para consultarlo en el futuro.

Instrucciones de uso en formato digital

Las **Instrucciones de uso** del Software DWOS se proporcionan en formato electrónico. Si necesita una versión en papel, puede imprimir estas instrucciones o solicitar al fabricante una versión impresa. Para obtener más información y consultar los plazos de entrega y datos de contacto, visite: <https://ifu.dentalwings.com/>.

1.1 Limitación de responsabilidad

El Software DWOS está diseñado para que lo utilicen personas que tienen los conocimientos pertinentes de odontología y tecnología de laboratorio dental.

El usuario del Software DWOS es el único responsable de determinar si el producto es adecuado para las circunstancias y el caso específico de cada paciente. El usuario del Software DWOS es el único responsable de la corrección, integridad y adecuación de todos los datos introducidos en el software. El usuario debe verificar la corrección, exactitud e integridad de los diseños realizados en el Software DWOS, y evaluar cada caso.

Los productos de Dental Wings deben utilizarse de conformidad con las instrucciones de uso correspondientes. En caso de uso o manipulación indebidos de los productos de Dental Wings, la garantía, si la hubiera, quedará anulada. Si necesita más información sobre el uso correcto de los productos de Dental Wings, póngase en contacto con su distribuidor local. No se permite al usuario modificar los productos de Dental Wings.

DENTAL WINGS, SUS EMPRESAS FILIALES Y DISTRIBUIDORES RENUNCIAN A TODO TIPO DE DECLARACIÓN Y GARANTÍA, YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA, ESCRITA O VERBAL, RESPECTO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN DETERMINADO FIN, FUNCIONAMIENTO SIN ERRORES O AUSENCIA DE INFRACCIÓN; ADEMÁS, LOS PRODUCTOS SE VENDEN TAL CUAL.

Nuestra responsabilidad máxima por los productos o su uso, derivada de la garantía, el contrato, un agravio o cualquier otro motivo, no podrá exceder los pagos recibidos por nosotros en virtud del precio de compra. En ningún caso seremos responsables de los daños especiales, incidentales o consecuentes, incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios, pérdida de datos o pérdida de uso, que puedan darse como consecuencia de la venta de los productos o después de esta.

Los componentes de software se actualizan periódicamente. Por lo tanto, algunas de las instrucciones, especificaciones e imágenes incluidas en las **Instrucciones de uso** podrían diferir ligeramente de su situación particular. Dental Wings se reserva el derecho a modificar o implementar cambios o mejoras en el producto o la documentación en cualquier momento, sin la obligación de notificar estas modificaciones o mejoras a nadie. El usuario tiene la obligación de mantenerse al tanto de las últimas novedades del Software DWOS.

Ciclo de vida del producto

El ciclo de vida del Software DWOS es de 3 años. Tras este periodo, el software puede continuar funcionando correctamente siempre que no se modifiquen la configuración ni el hardware, y se mantenga una licencia válida. No obstante, teniendo en cuenta que los requisitos legales y normativos cambian periódicamente, el fabricante legal no garantiza el cumplimiento del marco normativo más allá del periodo del ciclo de vida del producto de 3 años. Actualice su software regularmente para garantizar el cumplimiento normativo. Tenga en cuenta que el uso real del Software DWOS está sujeto al cumplimiento del marco de la licencia por parte del usuario.

Productos y datos de productos de terceros

Durante el escaneo y el diseño de casos, el usuario puede trabajar con productos y datos de productos de terceros. Dental Wings, sus filiales y distribuidores declinan toda responsabilidad por los daños que puedan derivarse del uso de productos o datos de productos de terceros en este contexto.

1.2 Licencia, marcas comerciales y otros derechos

Licencia del Software DWOS

El Software DWOS está protegido por un acuerdo de licencia, y podrá usarse y copiarse solo de conformidad con las condiciones de este acuerdo. Es ilegal copiar o usar el software en cualquier medio que no esté permitido en el acuerdo de licencia. Algunas de las aplicaciones de software puede requerir una clave de licencia adicional. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Disponibilidad

Es posible que algunos de los productos y accesorios mencionados en estas **Instrucciones de uso** no estén disponibles en todos los países.

Software de terceros

El Software DWOS contiene código de terceros proporcionado con licencias específicas. La lista de terceros y sus condiciones de licencia está disponible en *Información* en el Software DWOS (*consulte Etiqueta, p. 48*).

Nombres y marcas comerciales

Dental Wings Inc., DWOS y coDiagnostiX son marcas comerciales de Dental Wings Inc.

Straumann y CARES son marcas registradas de Straumann Holding AG, Suiza.

Microsoft y Windows son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

Todas las demás marcas comerciales y logotipos mencionados en el presente documento son marcas comerciales, marcas registradas o logotipos de sus respectivos propietarios.

Copyright

Los documentos de Dental Wings Inc. no podrán reimprimirse ni publicarse, ya sea de forma total o parcial, sin la previa autorización por escrito de Dental Wings Inc.

Patente

El Software DWOS puede utilizarse para diseñar y fabricar determinados productos protegidos por una o varias patentes o solicitudes de patente (visite www.straumann.com/uspatents).

2. Introducción y descripción general

2.1 Uso previsto

Software DWOS está diseñado para ser utilizado por los profesionales de la odontología con el objetivo de diseñar prótesis restauradoras.

2.2 Descripción y características del dispositivo

Software DWOS contiene una suite de software de planificación dental y diseño de restauraciones, como el software para pilares y SRBB (barras y puentes con tornillos), corona y puentes, armazones parciales, prótesis completas, férulas de mordida, modelos y diseños de sonrisa.

Importa y visualiza datos de sistemas de escaneo 3D para planificar y diseñar el dispositivo protésico restaurador correspondiente. El software permite exportar los resultados del diseño a sistemas de fabricación 3D. La transferencia de los datos cifrados se realiza mediante un estándar propio con DWOS Connect, entre otros medios.

Variantes y configuración

DWOS proporciona toda la funcionalidad y está diseñado para ser utilizado en laboratorios odontológicos. DWOS puede configurarse en función de las necesidades del cliente (p. ej., con solo un subconjunto de las aplicaciones disponible).

DWOS Easy está limitado en cuanto a los tipos de restauración que se pueden diseñar. El proceso general está simplificado y optimizado para el uso en laboratorios odontológicos.

DWOS Chairside está limitado en cuanto a los tipos de restauración que se pueden diseñar. El proceso general está simplificado y optimizado para el uso en clínicas odontológicas.

Principios del funcionamiento

Software DWOS proporciona soluciones para el diseño asistido por ordenador (CAD) y la fabricación asistida por ordenador (CAM) en la odontología digital. Es un sistema de software abierto, compatible con todos los sistemas odontológicos de escaneo y fabricación 3D que envían o reciben datos geométricos 3D en un formato de archivo abierto (p. ej., STL). También ofrece procesos validados que usan dispositivos odontológicos específicos de escaneo y fabricación 3D, así como materiales de determinados fabricantes.

Nuevas funciones

Software DWOS no contiene funciones que sean diferentes de las de la odontología convencional. El software permite realizar de forma digital servicios odontológicos convencionales relacionados con las prótesis restauradoras.

2.3 Accesorios y productos utilizados en combinación

Los siguientes productos pueden utilizarse en combinación con Software DWOS. Si desea información adicional, consulte *Información sobre compatibilidad* (p.9). Como Dental Wings Inc. valida continuamente otros accesorios y productos, también puede ponerse en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

Entrada

Software DWOS se ha validado con los siguientes escáneres 3D odontológicos:

- Escáner intraoral (DW-IO-100, DW-IO-001, DW-IO-010) para proporcionar datos 3D de la situación clínica
- Escáneres de sobremesa (DW-7-140, DW-3-90, Medit T500, Medit T310, Medit T510 y Medit T710) para proporcionar datos 3D

Cualquier otro escáner 3D que exporte datos 3D en un formato de archivo abierto y esté certificado para el escaneo odontológico puede, en principio, ser adecuado también. El usuario debe asegurarse de que los archivos cumplan los *Requisitos de entrada de datos* indicados a continuación. El usuario debe validar la adecuación de estos productos.

Fabricación

DWOS se ha validado para ser usado con los siguientes sistemas de fabricación 3D:

- Amann Girrbach: Straumann C/M/D Series

Cualquier otro sistema de fabricación 3D que use datos 3D en un formato de archivo abierto y esté certificado para la fabricación de restauraciones dentales puede, en principio, ser adecuado también. El usuario debe asegurarse de que el resultado cumpla los requisitos de la restauración dental.

Software

DWOS se ha validado para ser usado con el software de planificación de implantes coDiagnostiX®. El acceso a los casos de planificación de implantes se obtiene con DWOS Synergy.

Requisitos de entrada de datos

Precaución

El rendimiento del software depende de la calidad y precisión de los escaneos 3D importados. El usuario es el único responsable de garantizar que la calidad de los datos importados es suficiente para un rendimiento adecuado.

El software admite archivos STL de diferentes orígenes. La producción de escaneos en formato STL es responsabilidad exclusiva del usuario.

Para tener una calidad y una precisión suficientes en el escaneo, el raigón debe estar limpio y sus márgenes deben estar preparados para todas las restauraciones. En determinados casos, pueden ser necesarios preparativos adicionales de la boca, así como escaneos adicionales.

El software espera que todos los datos 3D estén definidos en milímetros, aunque las estructuras de intercambio subyacentes no tengan información explícita sobre las dimensiones.

2.4 Indicaciones

Software DWOS se utiliza para diseñar prótesis dentales restauradoras. Está diseñado para ser utilizado por profesionales de la odontología con conocimientos sobre el campo de aplicación correspondiente. El software importa y visualiza datos geométricos 3D dentales. Proporciona los resultados del diseño en una geometría 3D para la fabricación automática.

2.5 Contraindicaciones

Software DWOS no está diseñado para ser utilizado en contacto directo con el paciente ni con dispositivos de soporte vital.

2.6 Precauciones

Utilice una contraseña segura para reducir el riesgo de intrusión.

Cree copias de seguridad de sus datos a intervalos regulares. Es responsabilidad del usuario crear y mantener copias de seguridad de los datos para evitar pérdidas debidas a bloqueos del sistema o errores del hardware.

Asegúrese de cumplir todos los estándares y normativas técnicas aplicables a los escáneres y el hardware que use junto con el software DWOS.

El hardware en el que se instale el software solo debe usarse para el escaneo y el diseño. Los usuarios pueden instalar software adicional en el dispositivo, pero es responsabilidad de dichos usuarios asegurarse de que el software adicional no reduzca el rendimiento del software DWOS.

El software DWOS en su hardware no está diseñado para ser utilizado cerca (a menos de 1,5 metros) del paciente.

El usuario del software DWOS es el único responsable de la corrección, la exactitud y la integridad de todos los datos introducidos en el software DWOS.

El rendimiento del software depende de la calidad y precisión de los escaneos 3D importados. El usuario es el único responsable de garantizar que la calidad de los datos importados es suficiente para un rendimiento adecuado.

El software admite archivos STL de diferentes orígenes. La producción de escaneos en formato STL es responsabilidad exclusiva del usuario.

No diseñe restauraciones que puedan crearse a pesar de los mensajes de advertencia a menos que comprenda plenamente las consecuencias de estas advertencias y tenga claro que no se generarán riesgos inaceptables para la corrección y precisión de su diseño. No obstante, si necesita diseñar sin restricciones de materiales o juegos de implantes, póngase en contacto con el fabricante correspondiente para obtener su aprobación.

Garantice siempre una correspondencia biunívoca entre paciente, escaneo y caso de tratamiento.

El software DWOS realiza cálculos a partir del tamaño de unidad indicado en los datos de entrada. Compruebe siempre que los cálculos sean correctos. Para ello, use las dimensiones y las herramientas del software DWOS. Se asume que nuestro software muestra información correcta en sus cálculos, y que es responsabilidad del usuario comprobar el producto final para asegurarse de que las dimensiones sean correctas.

Los fabricantes de los implantes y el material han definido restricciones relativas a sus productos para garantizar que estos se destinen a su uso previsto. El software DWOS lo ayuda a aplicar esas restricciones mostrando las explicaciones pertinentes en mensajes de advertencia.

En determinados países, los materiales, los implantes y los pilares deben registrarse. Es responsabilidad del usuario asegurarse de incluir y usar únicamente datos aprobados en su país.

Las unidades de hardware utilizadas con el software no deben desecharse como residuos urbanos no seleccionados. La recogida debe efectuarse por separado.

2.7 Información sobre compatibilidad

Puede consultar la información sobre la compatibilidad entre el Software DWOS y otros productos en las instrucciones de uso del producto. Si estas no incluyen la información sobre compatibilidad, póngase en contacto con su distribuidor local.

Archivos de pedido

Los archivos de pedido o caso creados con el Software DWOS son retrocompatibles hasta cierto punto. Asegúrese de actualizar el software regularmente para reducir el riesgo de generar problemas de compatibilidad.

Los problemas de compatibilidad pueden surgir al exportar pedidos o archivos a otro sistema. Estos problemas pueden estar relacionados con restricciones de licencia o la disponibilidad de los materiales.

DWOS Connect

DWOS Connect permite la transferencia de datos cifrados. Tiene su propio ciclo de versiones. Todas las versiones de DWOS Connect son compatibles con todas las versiones de DWOS. Si una versión antigua de alguno de los dos productos no admite una función particular, es posible que falte información.

coDiagnostiX/DWOS Synergy

DWOS Synergy permite compartir casos en línea entre coDiagnostiX y DWOS (no está disponible para DWOS Chairside ni DWOS Easy). DWOS es compatible con la última versión de DWOS Synergy. Asegúrese de que el asociado de conexión funciona con la última versión de software de coDiagnostiX.

Escáner intraoral Dental Wings

Software DWOS es compatible con la versión 1.8 del software del escáner intraoral Dental Wings y posteriores.

2.8 Protección de datos

El sistema de licencias restringe el acceso al Software DWOS.

A fin de proteger los datos frente a la pérdida o el uso no autorizado, se han implementado varios mecanismos de seguridad en el Software DWOS:

- Cifrado de datos durante el almacenamiento y la transferencia a través de Internet.
- Sistema de archivado para crear copias de seguridad de los datos de pacientes y de diseño.
- Función de anonimización a petición para proteger la privacidad.

Es posible que se requiera un nivel de protección moderado o alto para garantizar la privacidad y evitar el uso indebido de los datos administrados por el usuario:

- Nivel alto: datos con requisitos legales adicionales en muchos países (p. ej., datos personales de pacientes e información médica).
- Nivel moderado: datos protegidos o restringidos por contrato u otros acuerdos (p. ej., la información de licencia).

Tenga en cuenta que el usuario es responsable de la protección de los datos que administre. Asegúrese de proteger estos datos de forma adecuada.

Precaución

Proteja sus datos frente a la pérdida, así como el acceso y uso no autorizados.

- Proteja su sistema informático con un firewall o detector de malware.
- Utilice una contraseña segura para reducir el riesgo de intrusión. Use una contraseña segura para proteger su sistema informático, medios de almacenamiento y dispositivos de presentación.
- Use el cifrado de datos para proteger los datos de su sistema informático y medios de almacenamiento.
- Realice regularmente copias de seguridad de los datos para prevenir la pérdida.
- Use las funciones de anonimización compatibles con su sistema para proteger los datos personales de los pacientes si fuera necesario.


2.9 Copia de seguridad de datos

Precaución

Cree copias de seguridad de sus datos a intervalos regulares. Es responsabilidad del usuario crear y mantener copias de seguridad de los datos para evitar pérdidas debidas a bloqueos del sistema o errores del hardware.

La base de datos contiene toda la información importante, incluidos los archivos de pedido y caso. Los archivos de pedido y caso contienen los escaneos y diseños de los casos actuales y archivados. Para hacer una copia de seguridad de la base de datos, proceda de la siguiente manera:

1. Abra la consola del servidor DWOS; para ello, haga doble clic en el icono de **DWServer** de la barra de tareas del ordenador.



2. Se abrirá la ventana de la consola. Abra la pestaña **Volcar base de datos**.



2.10 Información adicional

Dental Wings y sus productos están registrados en los principales mercados. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor local.

Para obtener más información acerca de los productos utilizados en combinación con el Software DWOS, consulte las siguientes fuentes.

coDiagnostiX:

- [Instrucciones de uso](#) de coDiagnostiX

Escáneres de sobremesa Dental Wings

- Instrucciones de uso de [3Series](#) o [7Series](#)

Escáneres de terceros

- [Guía de usuario](#) de Medit T310/T510/T710
- [Guía de usuario](#) de Medit T500

Escáner intraoral Dental Wings:

- [Instrucciones de uso](#) del escáner intraoral

2.11 Desecho



⚠ Precaución

Las unidades de hardware utilizadas con el software no deben desecharse como residuos urbanos no seleccionados. La recogida debe efectuarse por separado.

Los dispositivos eléctricos y electrónicos deben desecharse de forma independiente de los residuos domésticos normales con el fin de promover la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación; de este modo, se evitan los efectos adversos en el medio ambiente y la salud humana como consecuencia de la presencia de sustancias peligrosas en algunos de sus componentes, y se reduce la cantidad de desechos que deben eliminarse para así disminuir los residuos en los vertederos. Esto incluye accesorios como controles remotos, cables de alimentación, etc.

Para obtener más información sobre cómo desechar su dispositivo y el embalaje, póngase en contacto con su distribuidor local.

3. Instalación de Software DWOS

Precaución

El software DWOS en su hardware no está diseñado para ser utilizado cerca (a menos de 1,5 metros) del paciente.

El hardware en el que se instale el software solo debe usarse para el escaneo y el diseño. Los usuarios pueden instalar software adicional en el dispositivo, pero es responsabilidad de dichos usuarios asegurarse de que el software adicional no reduzca el rendimiento del software DWOS.

Inicie el software DWOS para verificar que aún funciona después de instalar nuevo software o hardware de terceros, o tras actualizar el sistema o software.

Asegúrese de cumplir todos los estándares y normativas técnicas aplicables a los escáneres y el hardware que use junto con el software DWOS.

Cómo instalar Software DWOS en su equipo

1. Compruebe que su hardware cumpla las especificaciones (*consulte Especificaciones de hardware y software recomendadas, p. 40*).
2. Haga doble clic en el instalador y siga las instrucciones de la pantalla.

Licencia

Si tiene la licencia en una llave, conecte la llave a un puerto USB de su dispositivo. Software DWOS está listo para usarse.

Si no tiene la licencia en una llave, debe enviar un formulario de solicitud de licencia. La primera vez que intente abrir el software, aparecerán en la pantalla unas instrucciones que le indicarán lo que debe hacer.

Rellene el archivo de solicitud y envíelo por correo electrónico a: license-request@dental-wings.com.

Cuando reciba la clave de licencia por correo electrónico, podrá seleccionar *Importar* en la ventana *Generador de licencias* y buscar el archivo que ha recibido. Software DWOS está listo para usarse.

Consulte *Principios básicos e interfaz de usuario (p.15)* y *Instrucciones paso a paso (p.21)* para usar el software.

Instalación de software opcional

DWOS Synergy

DWOS Synergy es una interfaz de comunicación entre coDiagnostiX y DWOS. Al compartir en tiempo real información sobre casos, permite la colaboración en la planificación de implantes basada en el resultado protésico. A menos que colabore mediante Internet, puede ser útil, para aumentar el rendimiento, instalar como mínimo un servidor Synergy en su red. Descargue la versión más reciente del servidor Synergy local en el sitio web de Dental Wings: www.dentalwings.com/resources/software-download. Para poder conectarse al servidor Synergy desde otros clientes, deben activarse puertos específicos (*consulte DWOS Synergy, p. 42*) (en la mayoría de los casos, esto lo hace automáticamente el programa de instalación).

Team Viewer

Team Viewer forma parte de la instalación. No es obligatorio, pero es un requisito para poder recibir soporte técnico remoto de su distribuidor o de Dental Wings. Para funcionar, Team Viewer accede a puertos específicos (*consulte Team Viewer, p. 44*).

Los usuarios de DWOS Chairside tienen un instalador en la sección [Descargas](#) del sitio web de Dental Wings.

Lector de PDF

Un lector de PDF solo es necesario para Software DWOS instalado en dispositivos con Microsoft® **Windows**®. Si no tiene un lector de PDF disponible, instale uno compatible con su sistema operativo.

Navegador web

Es necesario un navegador actualizado compatible con su sistema para acceder a la ayuda en línea.

Idiomas

Software DWOS está disponible en varios idiomas. El idioma viene predefinido. De no ser así, o si está definido de forma incorrecta, póngase en contacto con su distribuidor local.

Desinstalación

Si necesita desinstalar su Software DWOS por cualquier motivo, use las herramientas y los procedimientos de su sistema operativo (*consulte Datos técnicos y etiqueta, p. 40*).

4. Principios básicos e interfaz de usuario

4.1 Nociones básicas

Para aprender a trabajar con el software DWOS y familiarizarse con sus funciones y con los procesos relacionados, se ofrecen las siguientes instrucciones, el siguiente material de aprendizaje y los siguientes elementos multimedia:

- Software DWOS **Instrucciones de uso** (este documento) (*consulte Instrucciones paso a paso, p. 21*)
- Vídeos de aprendizaje disponibles en línea: www.dentalwings.com/training/
- Software DWOS proporciona ayuda integrada. Es posible que parte del contenido requiera conexión a Internet para visualizarse.



Para visualizar el contenido de ayuda, haga clic en el icono de **Ayuda** en la barra de herramientas.



Para visualizar la ayuda contextualizada, haga clic en los iconos pequeños situados en las estaciones del diseñador de Software DWOS.

- Cada nueva versión del software DWOS incluye la información que describe las nuevas funciones y mejoras, así como las correcciones de errores. Esta información se encuentra en las notas de la versión, disponibles en línea: www.dentalwings.com/release-notes/

Si tiene más preguntas, póngase en contacto con su distribuidor local.

4.2 Inicio del software

Software DWOS se basa en una arquitectura cliente/servidor. Por ello, al iniciar el software, el servidor se inicia en segundo plano. Se muestra la pantalla de presentación con una barra de progreso. Cuando el servidor se está ejecutando, el cliente se inicia automáticamente. La pantalla de inicio de sesión aparece cuando el cliente está listo.

Para iniciar la aplicación, haga doble clic en el acceso directo del escritorio de su dispositivo.

Software DWOS



Haga clic en el icono del cliente DW para iniciar el servidor y el software.

DWOS Easy



Haga clic en el icono para iniciar el servidor y DWOS Easy.


DWOS Chairside



Haga clic en el icono para iniciar el servidor y DWOS Chairside.

Cierre del software

- Haga clic en la X en la esquina superior derecha de la ventana de la aplicación para cerrar el cliente DW.
- Haga clic con el botón derecho en el icono del *servidor DWOS* en la esquina inferior derecha de la bandeja del sistema de Windows y seleccione *Salir*.



- Consulte las instrucciones de Windows para apagar el equipo.

4.3 Interfaz de usuario

Software DWOS funciona principalmente con iconos. El proceso de diseño de prótesis lo sugiere el orden en el que aparecen los iconos en la barra de menús de iconos.

DWOS

La barra de herramientas horizontal principal permite ejecutar las estaciones DWOS de la suite, como las de creación de pedidos, escaneo de arco, diseño de coronas y puentes, etc. El proceso se sugiere de izquierda a derecha. Tenga en cuenta que los iconos visualizados en su barra de herramientas dependen de su configuración. Los números visualizados en los iconos de las estaciones indican el número de casos en espera en cada estación.





Creación de pedidos

En esta estación puede crear archivos de pedido con los detalles de la prótesis y los archivos de diseño y los escaneos correspondientes.



Bandeja de entrada

La bandeja de entrada es una interfaz de DWOS Connect, la plataforma en la nube de uso compartido de casos.



Escaneo de arco




Escaneo Multi-Die

Iconos de adquisición de datos. Inician una estación de escaneo cuando Software DWOS está instalado en un escáner compatible o inician el procedimiento de importación de escaneos. El procedimiento de escaneo se describe detalladamente en las Instrucciones de uso del escáner.



Importación de escaneos




Diseño CAD



Diseño de férula de mordida



Diseño de ortodoncia



Diseño parcial

El tercer grupo de iconos proporciona acceso a las diferentes estaciones de diseño, destinadas a diferentes tipos de restauración.




Gestión de producción

Acceda a esta estación para enviar diseños a producción y consultar pedidos enviados desde una estación de diseño.

Las Preferencias del usuario y los iconos de Ajustes están a la derecha de la barra de menús. Puede acceder a la ayuda web contextualizada desde el icono de la boya.

DWOS Easy



Easy aplica un sencillo enfoque en el que la anatomía es lo primero, lo que significa que la anatomía se define en primer lugar y, a continuación, se añaden los ajustes.

Tras **Escanear** y después de la **Configuración** inicial, puede definir a grandes rasgos la **Anatomía** que desee. A continuación, puede trabajar en los detalles de la restauración con los kits de herramientas disponibles para **Parte inferior, Carcasa y Núcleo**.

Por último, puede **Revisar** su restauración antes de pasar a **Anidado** y **Exportación**.

DWOS Chairside



La interfaz de Chairside lleva el caso por los pasos de diseño. El proceso es lineal y, para recorrer los pasos, debe hacer clic en el botón **Siguiente** que aparece en la esquina inferior derecha de cada vista.

Después de la bandeja de entrada y el espacio de trabajo, hay una estación para acceder a la base de datos y gestionarla y otra para la configuración general.

Control por ratón

El software DWOS requiere un ratón con dos botones y una rueda. La interacción con el ratón sigue los principios que se indican a continuación:

- Hacer clic: selección, definición de puntos
- Hacer clic con el botón derecho: validación, acceso al menú contextual
- Girar la rueda: acercar y alejar
- Mantener presionada la rueda mientras se arrastra el ratón: trasladar vista
- Mantener presionado el botón derecho mientras se arrastra el ratón: girar vista
- Mantener presionado el botón CTRL mientras se gira la rueda: genera una corte transversal de la vista
- Hacer doble clic: centrar la vista y cambiar su tamaño
- Hacer doble clic con el botón derecho: cambiar entre proyección en perspectiva y paralela

4.4 Diseño de restauraciones

El motor CAD de DWOS genera propuestas de restauración a partir de la siguiente información:

- Tipo de restauración definido en el pedido
- La emergencia (línea del margen) dibujada por el usuario en los datos del escaneo
- El eje de inserción indicado (automático o definido por el usuario)
- Las restricciones de materiales
- Las restricciones del proceso de exportación
- El juego de anatomía preseleccionado

Cuando está activada la tecnología de cadena de dientes, el cálculo también tiene en cuenta algunos análisis contextuales y estadísticas disponibles.

La estación CAD proporciona un conjunto de herramientas de modelado para personalizar esta propuesta inicial. También pueden importarse datos adicionales del escaneo (como los de encerado, CBCT o escaneo de cara) para verificar el diseño.

Los archivos de fabricación de la prótesis se extraen en un formato STL abierto y pueden enviarse a un fabricante con DWOS Connect o por otros medios.

Datos complementarios

Bibliotecas de anatomía

Dental Wings proporciona con el software algunos juegos de anatomía predeterminados. Las anatomías de los dientes se usan para calcular las propuestas automáticas de restauraciones. Para descargar más juegos de anatomía, haga clic [aquí](#). Los usuarios pueden duplicar los juegos existentes y modificar o sustituir las anatomías con archivos STL importados para crear sus anatomías personalizadas.

Juegos de fijaciones

Dental Wings proporciona con el software algunos juegos de fijaciones predeterminados. Las fijaciones se pueden añadir a los diseños para unir los componentes de una restauración (p. ej., para unir una prótesis a una barra o para crear un puente dividido). Para descargar más juegos de fijaciones, haga clic [aquí](#).

Archivos de material

Los archivos de material garantizan que los diseños respeten las restricciones estructurales y de fabricación de un material determinado. Dichos archivos debe crearlos el fabricante del material. Si la normativa lo permite, también puede trabajar con los archivos de material predeterminados facilitados por Dental Wings. Los usuarios pueden duplicar los archivos de material y modificar los parámetros para adaptarlos a su proceso.

Bibliotecas de implantes

Los juegos de implante virtuales se han creado específicamente para que, cuando se escanea un pilar para escaneo, el software analice los archivos con el objetivo de colocar con precisión el implante y su interfaz. Dichos archivos debe crearlos el fabricante del implante. Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener esos archivos.

5. Instrucciones paso a paso

Teniendo en cuenta la amplia variedad de indicaciones que pueden diseñarse con el software DWOS, en las presentes Instrucciones de uso únicamente se mostrará detalladamente un caso de ejemplo. Encontrará más procedimientos e instrucciones en la ayuda web (*consulte Nociones básicas, p. 15*).

Precaución

El usuario del software DWOS es el único responsable de la corrección, la exactitud y la integridad de todos los datos introducidos en el software DWOS.

Garantice siempre una correspondencia biunívoca entre paciente, escaneo y caso de tratamiento.

Los fabricantes de los implantes y el material han definido restricciones relativas a sus productos para garantizar que estos se destinen a su uso previsto. El software DWOS lo ayuda a aplicar esas restricciones mostrando las explicaciones pertinentes en mensajes de advertencia.

No diseñe restauraciones que puedan crearse a pesar de los mensajes de advertencia a menos que comprenda plenamente las consecuencias de estas advertencias y tenga claro que no se generarán riesgos inaceptables para la corrección y precisión de su diseño. No obstante, si necesita diseñar sin restricciones de materiales o juegos de implantes, póngase en contacto con el fabricante correspondiente para obtener su aprobación.

El software DWOS realiza cálculos a partir del tamaño de unidad indicado en los datos de entrada. Compruebe siempre que los cálculos sean correctos. Para ello, use las dimensiones y las herramientas del software DWOS. Se asume que nuestro software muestra información correcta en sus cálculos, y que es responsabilidad del usuario comprobar el producto final para asegurarse de que las dimensiones sean correctas.

En determinados países, los materiales, los implantes y los pilares deben registrarse. Es responsabilidad del usuario asegurarse de incluir y usar únicamente datos aprobados en su país.

5.1 Caso de ejemplo en DWOS

Diseño de un puente de 3 unidades

Este procedimiento abarca los pasos para diseñar una restauración de contorno completo dentosoportada de 3 unidades.



Figura 1: Restauración fabricada



Creación de pedidos

1. Vaya a la estación **Creación de pedidos** y seleccione el tipo de pedido **Cnb e implante**.
2. Se genera automáticamente un **ID del pedido**.
3. Introduzca los nombres del **Dentista** y el **Paciente**.
4. En el menú desplegable **Familia de prótesis**, seleccione **Coronas**.
5. **Material**: seleccione el material del puente. DWOS proporciona un conjunto de archivos de material genérico, pero el fabricante del material puede proporcionarle archivos de material personalizados en formato .XLM que puede importar en la estación **Gestión de material**.
6. **Color**: si el material que ha seleccionado se presenta en blancos de diferentes tonos, seleccione el tono del paciente medido por el médico.
7. **Subtipo de prótesis**: **Corona completa**.
8. **Familia de anatomía**: seleccione una anatomía de referencia para calcular la propuesta inicial.
9. En la ilustración, haga clic en los números de diente de los pilares del puente (dientes preparados). En nuestro ejemplo, serían los **números 14 y 16**. Las dos coronas aparecen en la definición de la capa base.
10. Vuelva al menú **Familia de prótesis** y seleccione **Pónticos**.
11. **Subtipo de prótesis**: **Póntico completo**.
12. En la ilustración, haga clic en la posición del diente ausente, el **número 15** en nuestro caso de ejemplo. El póntico aparece en la definición de la capa base.
13. Vuelva a seleccionar los números de diente 14, 15 y 16, y haga clic en el botón **Crear puente**. La definición de la capa base muestra un puente en lugar de tres unidades individuales.
14. Haga clic en el botón **Enviar pedido**.

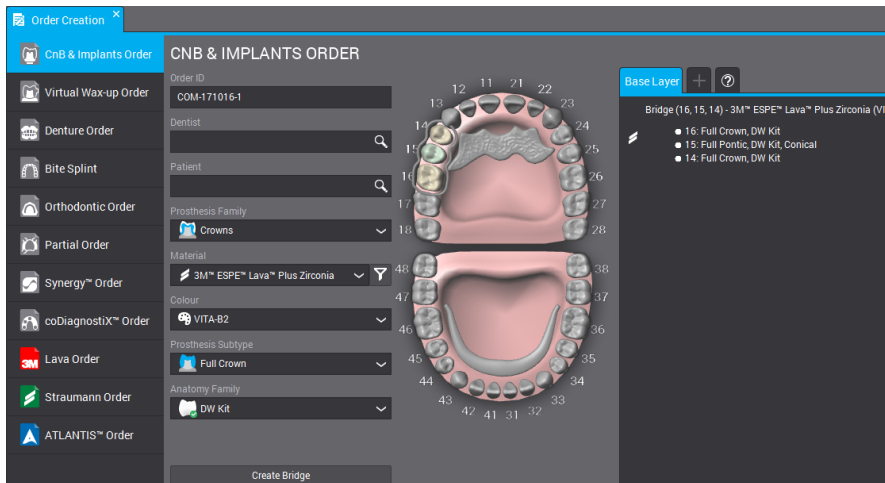


Figura 2: Pedido completado

Importación de escaneos

El diseño de prótesis se hace en un escaneo de superficie del contexto clínico. Consulte *Accesorios y productos utilizados en combinación* (p.7) para obtener más información acerca del requisito de estos escáneres.

Es posible adquirir datos de superficie a través de DWOS (siempre que esté instalado en un escáner compatible) en la estación *Escaneo de arco* o *Multi-Die*. Consulte las instrucciones del manual del usuario proporcionado por el fabricante del escáner.

También puede importar los escaneos a través de la estación *Importación de escaneos*.

1. Abra la estación **Importación de escaneos**.
2. El pedido creado debe aparecer en el panel izquierdo. Arrastre el pedido y suéltelo en la ventana principal.
3. Seleccione al menos un **Archivo de escaneo de arco**; para ello, haga clic en el icono de carpeta y busque el archivo .STL.
4. En este ejemplo, dado que estamos diseñando una restauración de contorno completo, necesitamos cargar un archivo de arco antagonista.
5. Cargue además un **archivo de escaneo de llave de oclusión** para volver a colocar los arcos superior e inferior juntos y, a continuación, haga clic en Aceptar en la ventana **Cargar archivo 3D para la definición clínica**.




Figura 3: Arrastrar y soltar el pedido en la ventana principal





Figura 4: Hacer clic en el icono de carpeta para cargar un archivo .STL

6. Haga clic en **Sí** en la ventana emergente para ajustar el *eje vertical principal*.
7. Con el botón derecho del ratón, coloque el arco en una vista oclusal.
8. Coloque la línea verde de manera que coincida con el escaneo; para ello, arrastre los puntos centrales y de los extremos, y los mandos *BUCAL*.
9. El **Diseñador de asignación de modelo** se abre para identificar en el escaneo las piezas para las que se ha solicitado un diseño de prótesis. Los números se adjuntan al cursor; haga clic en el diente correspondiente del escaneo de arco. Los elementos adyacentes se etiquetan automáticamente como diente o encía.
10. Diseñe el margen; para ello, coloque los puntos verdes en la línea de preparación. Está pasará a ser la línea de emergencia.
11. Ajuste el eje de inserción para la prótesis y valide los parámetros de diseño.
12. Para enviar el pedido, haga clic en **Cerrar diseño actual** .




Figura 5: Colocar el arco en una vista oclusal




Figura 6: Colocar la línea verde para que coincida con el escaneo




Figura 7: Identificar los dientes en el escaneo






Figura 8: Importación de escaneo completada

Diseño

1. Abra la **estación CAD** Corona y puente.
2. Mientras se calcula una propuesta automática para su pedido, debajo del ID del pedido se muestra una barra de progreso. Una vez finalice el proceso, arrastre el pedido y suéltelo en la ventana principal.



3. Se muestra la propuesta automática. Puede usarse tal como está, o bien modificarse con la ayuda de una amplia selección de herramientas de modelado disponibles en el menú contextual (menú que aparece al hacer clic con el botón derecho).
4. Para enviar el pedido, haga clic en **Cerrar diseño actual** .

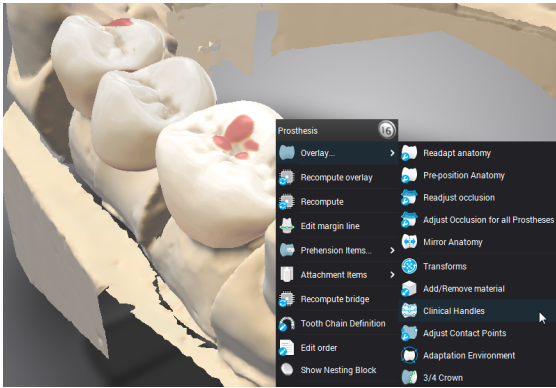


Figura 9: Las herramientas de modelado están disponibles en el menú contextual




Figura 10: Diseño completado

Existen diferentes maneras de modelar la prótesis: (1) Cambiar los parámetros de cálculo con las funciones **Recalcular**. (2) Transformar la superficie real con herramientas de modelado como **Añadir/Eliminar material**, **Mandos clínicos**, **Transformaciones**, etc. (3) Usar los ajustes automáticos de los contactos interproximal y oclusal. Deben utilizarse en orden secuencial para evitar sobrescribir el trabajo realizado.



Enviar a producción

1. Abra la estación **Gestión de Producción**.
2. Haga clic con el botón derecho en el pedido y el subcontrato (necesita una cuenta DWOS Connect), o extraiga los archivos de fabricación para enviarlos por sus propios medios.

5.2 Caso de ejemplo en DWOS Chairside

Diseño de una corona completa de una sola unidad

Casos activos

Al guardar un caso en el directorio de importación, este se muestra automáticamente en la lista **Casos activos**. Seleccione un caso para revisar la receta, o modificar o completar la información de fabricación, y ábralo.

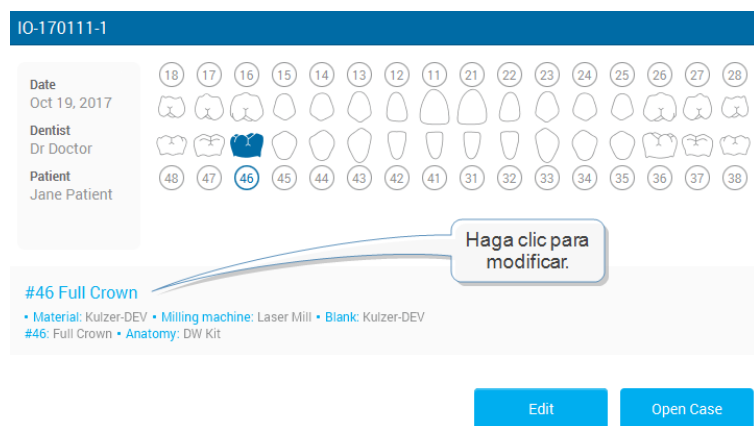


Figura 11: Revisión de la información del caso

Revisión de pedidos

Optimización de la malla (opcional)

Dado que los intradós de la prótesis se calculan en parte a partir de un desplazamiento de la superficie escaneada, este paso sirve para modificar los escaneos superficiales antes de calcular una corona en ellos. En determinadas situaciones, resulta útil eliminar las superficies no deseadas, reparar los orificios y modificar la geometría.

Posicionamiento

Coloque el escaneo de arco en el referencial de DWOS Chairside de los ejes x, y y z.

Asignación

Identifique la preparación y sus elementos adyacentes al hacer clic en el número de diente solicitado.

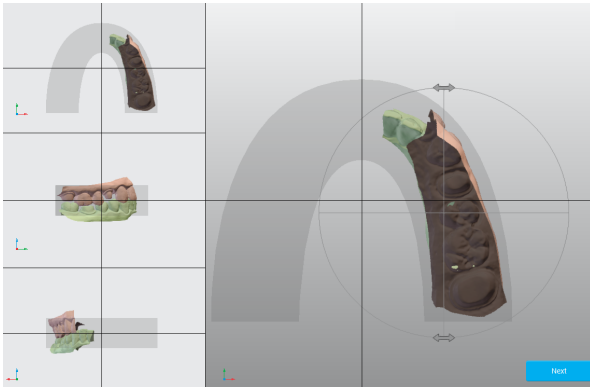


Figura 12: Posicionamiento




Figura 13: Definición de la cadena de dientes

Parámetros de diseño

Línea del margen

Diseñe el margen; para ello, coloque los puntos verdes en la línea de preparación. Esta pasará a ser la línea de emergencia.

Eje de inserción

Se calcula y muestra el mejor eje de inserción para la corona. También pueden realizarse ajustes manuales.

Diseño de anatomía

En este paso, el software calcula una propuesta automática para la corona. Puede usarse tal como está, o bien modificarse con la ayuda de una selección de herramientas de modelado disponibles en la ventana del editor de diseño. Seleccione la corona para que se habiliten las herramientas. La pantalla puede personalizarse para mostrar u ocultar diferentes elementos. Puede añadirse una vista alternativa de apoyo para el paso de diseño.

Anidado

El siguiente paso es colocar la corona en el blanco de fresado seleccionado.

Exportación

El último paso tiene por objetivo configurar los datos enviados al software CAM que controla el dispositivo de fresado.




Figura 14: Definición del margen

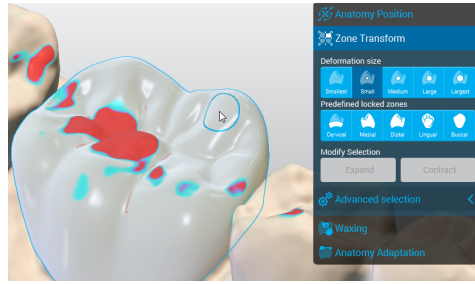


Figura 15: Seleccione la corona para que se habiliten las herramientas




Figura 16: Coloque la corona en el blanco

5.3 Caso de ejemplo en DWOS Easy

Diseño de una corona e incrustación onlay


Crear un nuevo caso

Vaya a **Casos activos**.

Puede importar archivos .xorder o los escaneos de modelo para crear nuevos casos.

Edite el caso si necesita cambiar la receta del dentista o ver los archivos o adjuntos de los escaneos importados.

Abra el caso para iniciar el procesamiento.

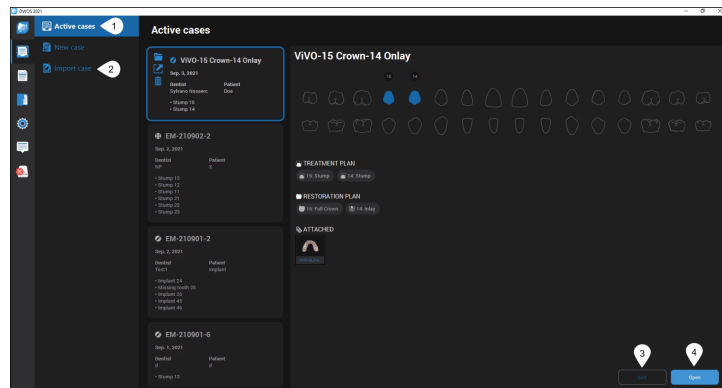

Next

Recortar


En este paso, puede colocar el modelo y eliminar el resto de materiales. Para ello, seleccione primero el modelo. Debe ver un contorno azul.

Tallar

Seleccione las opciones de tallado adecuadas para su caso.

En profundidad: la selección atraviesa los planos de la vista en 3D.

En superficie: la selección se aplica solo al plano visible.

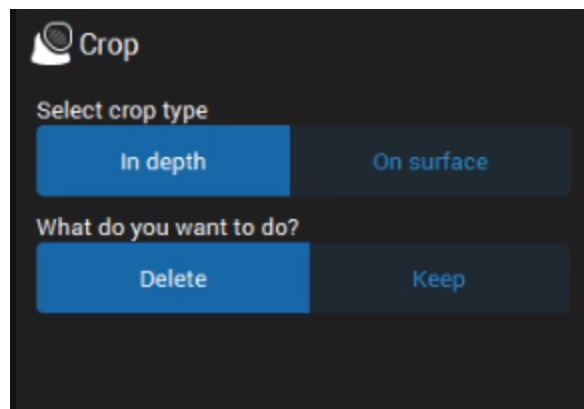


Coincidencia

Utilice esta función para alinear los modelos superior e inferior con la llave de oclusión, o los escaneos de encía o encerado con el modelo.

Coincidencia inteligente: alinea automáticamente las superficies.

Coincidencia de 3 puntos: solicita que se sitúen tres puntos en las superficies que se desean alinear para precisar la coincidencia.

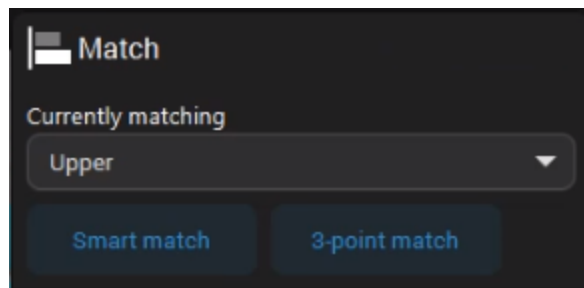


Orientación

En este paso, puede alinear el modelo en los ejes de referencia del software.

Parte delantera: coloque las superficies de mordida en la cuadrícula de oclusión.

Derecha: coloque las superficies de mordida en el plano horizontal.

Lado superior: revise el plano oclusal.

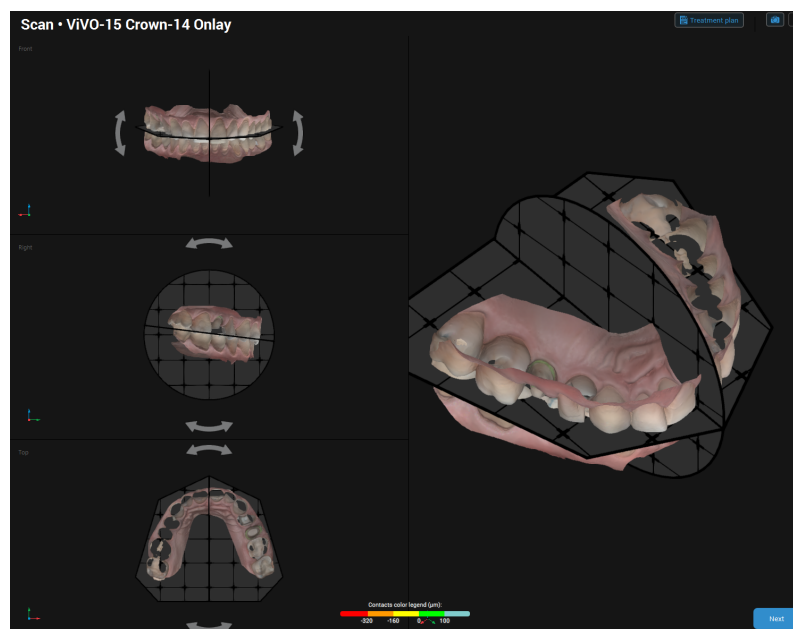


CONFIGURACIÓN: Etiquetado

En este paso, se asignan números a los dientes preparados o ausentes y a los implantes, así como a los elementos adyacentes. El etiquetado comienza por el elemento adyacente situado más a la izquierda y continúa en el sentido de las agujas del reloj.

Etiquete el elemento adyacente del diente definido que esté situado más a la izquierda.

La segunda etiqueta es el primer diente definido del caso.

Haga clic en **Añadir** para etiquetar dientes aparte de los definidos de forma predeterminada.



Next

CONFIGURACIÓN: Biblioteca de anatomías

En este paso, puede seleccionar la anatomía preliminar más adecuada para el caso. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione una anatomía en las bibliotecas disponibles.

Next

La posición de la anatomía se calcula en función de la posición de los elementos adyacentes.

DISEÑO: Anatomía

En este paso, puede cambiar la anatomía propuesta con el clon de un diente existente. También puede usar las herramientas 3D para colocar, tallar, rellenar o alisar las superficies de la anatomía.

Duplicar

Cambie la anatomía existente por el clon de un diente existente.


1. Haga clic en la flecha hacia abajo y seleccione el diente que desea clonar.
2. Haga clic en **Aplicar**.




Ajustar

Coloque aproximadamente la anatomía en la vista en 3D. Puede utilizar **Mayús** y **Ctrl** con los mandos amarillo y morado para las transformaciones simétricas.


Utilice los **mandos amarillos** para girar la anatomía de forma vertical u horizontal.



Utilice los **mandos morados** para modificar la pared de la anatomía y así ajustar el espaciado interdental.



Utilice los **mandos verdes** para ajustar las dimensiones verticales y horizontales de la anatomía.



Moldear


Use las herramientas 3D para transformar, rellenar o alisar las superficies de la anatomía. Puede usar los mandos para modelar las superficies que cubren o el círculo para ajustarlas libremente.

El **círculo azul** muestra la cobertura de la herramienta libre. La línea azul representa el eje de la deformación.

Haga clic en cualquier mando para tallar la superficie que está debajo. Presione **Alt** para mover el mando seleccionado a un punto diferente de la superficie.


Presione **Mayús** para tallar la superficie ubicada debajo de los mandos del mismo color situados en el mismo lado.

Presione **Ctrl** para tallar la superficie cervical oclusal ubicada bajo los mandos de diferentes colores.

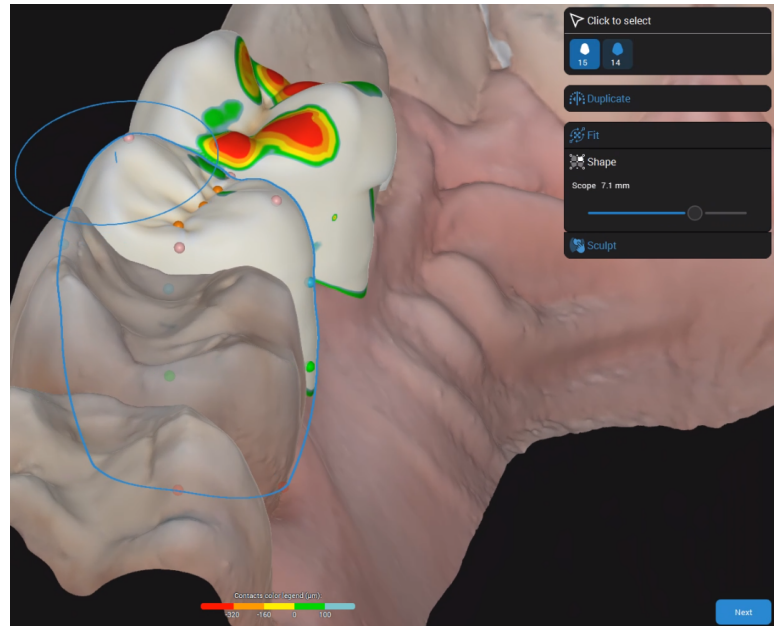

Tallar

Añada o elimine material en las superficies de la restauración según sea necesario.



Next

DISEÑO: Parte inferior

Al acceder a este paso por primera vez, el **Plan de tratamiento** se abre y solicita que se definan los tipos de restauración.


En este paso, puede definir las partes inferiores de la restauración.

Línea del margen

Detección inteligente: coloque los puntos. La línea que los conecta tiene en cuenta las irregularidades.

Punto a punto: coloque los puntos conectados por una línea recta.

Proponer: obtenga una propuesta de margen que puede ajustar según sus necesidades.




Eje de inserción

El eje de inserción se muestra de forma predeterminada, pero puede modificarlo.

Definir como vista: haga clic tras haber colocado la vista en 3D para obtener un eje idóneo.

Vista en 3D: haga clic en el mando con forma de diamante y muévelo hasta obtener el eje idóneo.


Predeterminado: haga clic para restaurar la propuesta predeterminada.




Las irregularidades generadas por el posicionamiento del eje de inserción se marcan en la vista 3D.

Ajuste

Al modificar las opciones de ajuste, el valor seleccionado se resalta y actualiza en consecuencia en la vista en 3D.


Haga clic en  para acceder a más opciones de ajuste.



Espesura de material

Se define la espesura mínima que asegura la integridad de la restauración durante la fabricación.

También garantiza que se respete la espesura mínima recomendada por el fabricante del material.



Next

DISEÑO: Carcasa


En este paso, puede ver la anatomía consolidada unida a la parte inferior. Ya puede ajustar los puntos de contacto oclusales y proximales.

Oclusal

Ajuste el espacio o los contactos entre la restauración y el modelo opuesto.


Introduzca el valor de la distancia entre la restauración y el elemento opuesto.

Haga clic en **Aplicar**.

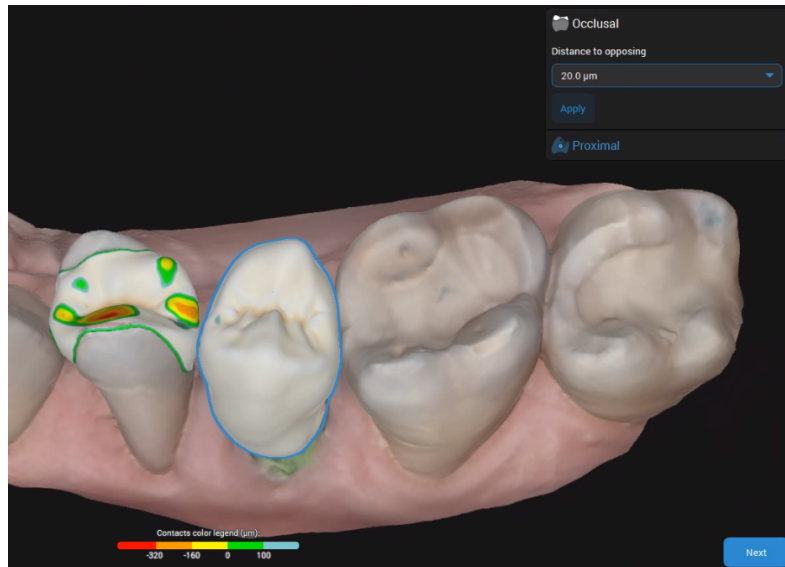

Proximal

Ajuste los contactos proximales. Puede añadir puntos de contacto mesiales, distales o mesiales-distales.

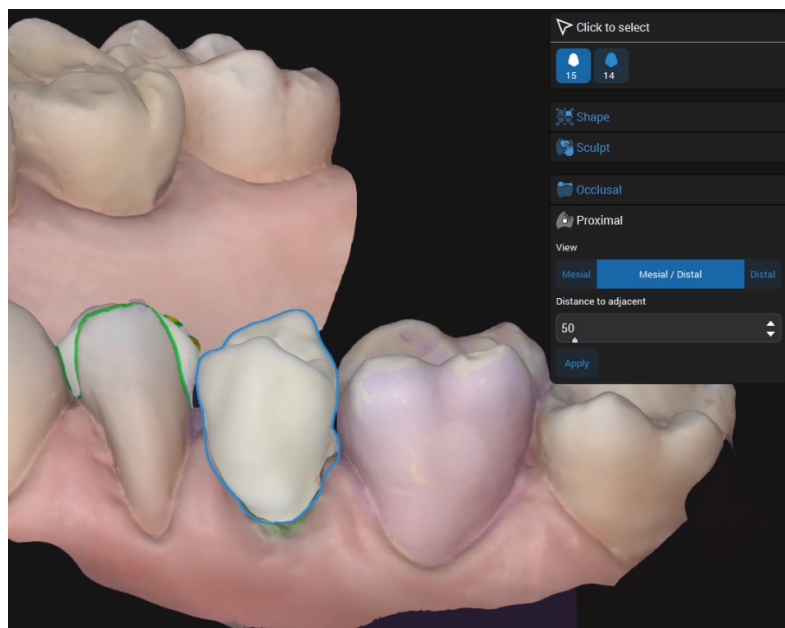

Next

DISEÑO: Revisar

En este paso, se valida el diseño de restauración final, que ya está listo para producir. Aún puede alisar las superficies de la restauración para perfilarla y mejorar así su apariencia.

ANIDADO

En este paso, puede ajustar la posición de la restauración en el bloque, así como la posición o el tipo de colado utilizado.

El anidado solo está disponible si el material escogido para la restauración está certificado por Straumann.

EXPORTACIÓN

En este paso, hay varias opciones disponibles según el tipo de restauración escogido.

- Para las restauraciones a partir de materiales genéricos, puede exportar los datos del caso en formato STL.
- Para las restauraciones producidas por Straumann, hay varias opciones disponibles.

1. Complete la información necesaria. Haga clic en ENVIAR.

2. El **Centro de notificaciones** muestra las actualizaciones del estado del caso (si se ha enviado o no).

El caso se elimina de **Casos activos** y se guarda en el directorio **Casos**.

6. Mantenimiento

Software DWOS no requiere que el fabricante realice ningún mantenimiento durante el ciclo de vida del producto.

Sin embargo, el usuario es responsable de:

- Asegurarse de que se creen copias de seguridad de los datos regularmente para evitar la pérdida de datos (*consulte Copia de seguridad de datos, p. 11*).
- Actualizar el software como se indica en *Ciclo de vida del producto (p.4)* para garantizar el cumplimiento de la normativa después del ciclo de vida del producto original. Si tiene una conexión a Internet activa, el usuario recibe notificaciones automáticas sobre las actualizaciones pendientes.

Actualizaciones

DWOS

La herramienta de actualización de DWOS puede iniciarse desde el escritorio dental de DWOS, la sección [Descargas](#) del sitio web o la pantalla de inicio de sesión.

La herramienta de actualización de DWOS también está disponible en línea:

<https://updates.dwos.com/updater/index.html>.

DWOS Easy / DWOS Chairside

La sección de noticias de la pantalla de inicio de sesión muestra el estado de su versión del software y proporciona un vínculo para actualizarla si usted no está ejecutando la versión más reciente disponible.

Después de iniciar sesión, también puede hacer clic en **Ajustes > ¿Desea actualizar ahora?**.

7. Distribuidores y servicio

Solicite servicio a personal de servicio autorizado. Póngase en contacto con su distribuidor local si necesita soporte técnico en relación con el software DWOS.

También puede escribir a support@dental-wings.com (en inglés, francés o alemán).

8. Datos técnicos y etiqueta

8.1 Especificaciones de hardware y software recomendadas

Requisitos mínimos		
	DWOS/DWOS Easy	DWOS Chairside
Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 de 64 bits	Microsoft® Windows® 10 de 64 bits
Disco duro	HDD/SDD de 500 GB	HDD/SDD de 500 GB
Procesador	Quad Core de 3,30 GHz [Intel Core i5 de 3,30 GHz]	Intel Core i7-6770 o superior
Memoria	RAM de 16 GB	RAM de 16 GB
Tarjeta gráfica	Nvidia GeForce 1050 Ti	Tarjeta gráfica de última generación. Debe ser compatible con las tarjetas de vídeo discretas Open GL3: Intel Iris 540/580, AMD o Nvidia de menos de 3 años
Pantalla	Pantalla de 22 pulgadas y 1080p	Pantalla de 22 pulgadas y 1080p
Ratón	Ratón USB (con dos botones y rueda)	Ratón USB (con dos botones y una rueda) Opcional si se usa pantalla táctil
Teclado	Teclado USB	Teclado USB Opcional si se usa pantalla táctil

Se han especificado unos requisitos recomendados para permitir un funcionamiento estable de Software DWOS. El software también podría ejecutarse en configuraciones de mayor rendimiento. El usuario debe validar la adecuación de estas configuraciones.

Red

Conexiones	
Conexión a Internet	Conexión a Internet de banda ancha Requerida para la ayuda del usuario, las actualizaciones en línea, el soporte remoto, DWOS Connect y DWOS Synergy
Conexión de red	Requerida para la conexión local de DWOS Synergy

8.2 Hardware y software opcionales

Software opcional	
Acceso remoto (para el soporte técnico)	Team Viewer
Colaboración con coDiagnostiX	DWOS Synergy

Consulte *Instalación de software opcional (p.14)* para obtener más información acerca del software mencionado.

Hardware opcional	
	DWOS/DWOS Chairside
Dispositivos periféricos	Dispositivo de navegación en 3D de 3DConnexion

8.3 Puertos usados en la instalación del software

Servidor DWOS

Tras la instalación de Software DWOS en un dispositivo, el servidor DWOS usa los siguientes puertos:

Servidor DWOS	
DWOS	DWOS Chairside / DWOS Easy

Servidor DWOS			
RMI	Puertos 1099 y 9000	1098 y 9001	Entrante
mysql	Puerto 61324	Puerto 37132	Entrante
Servidor de parámetros	Puerto 49408	ninguno	Entrante
rest	Puerto 9696	Puerto 9696	Entrante

Herramienta de actualización de DWOS

Tras la instalación de la herramienta de actualización de DWOS en un dispositivo, se usan los siguientes puertos:

Herramienta de actualización de DWOS		
http	Puerto 80	Saliente
https	Puerto 443	Saliente
ssh	Puerto 22	Saliente
rest	Puerto 9997	Saliente

DWOS Synergy

Para poder conectarse al servidor DWOS Synergy desde otros clientes, deben activarse los siguientes puertos (en la mayoría de los casos, esto lo hace automáticamente el programa de instalación):

Servidor DWOS Synergy		
Puerto 15672	Interfaz de administración del servidor RabbitMQ	Entrante
Puerto 61613	Protocolo STOMP: comunicación con coDiagnostiX	Entrante
Puerto 5672	Protocolo AMQP: comunicación con Dental Wings DWOS o Straumann CARES	Entrante
Puerto 61615	Distribuidor de cola de mensajes STOMP	Entrante

Servidor DWOS Synergy

Puerto 55555 (UDP)	Consulta de difusión	Saliente
Puerto 55556 (UDP)	Cliente de escucha de difusión	Entrante

Team Viewer

Tras la instalación de Team Viewer en un dispositivo, se usan los siguientes puertos:

Team Viewer	
Puertos 5938, 443 y 80	TCP/UDP




8.4 Configuración y accesorios




DWOS está disponible en tres opciones de configuración. Consulte la siguiente tabla para obtener información detallada acerca de los módulos y las opciones de configuración disponibles.

Módulos de DWOS	Gold	Productivity	Platinum	Optional
Corona y puente	●	●	●	
Implantes y barras y puentes con tornillos	●	●	●	
Generador de modelos	●	●	●	
Armazones parciales		●	●	
Prótesis completas			●	●
Férulas de mordida			●	●
Archivado de ortodoncia			●	●
Prototipado rápido				●
Módulo CAM				●
Cirugía guiada				●

Aplicaciones de DWOS Chairside	Opcionalmente disponible
Módulo CAM	●

Piezas accesorias	DWOS /DWOS Easy	DWOS Chair side	N.º de pieza	Imagen	Uso previsto
Escáner 3Series	●		Accesorio (1001-10)		3Series está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).
7Series Escáner	●		Accesorio (1003-10)		7Series está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).
Escáner Medit T500	●		Accesorio (SET00000044)		El escáner Medit T500 está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).

Piezas accesorias	DWOS /DWOS Easy	DWOS Chair side	N.º de pieza	Imagen	Uso previsto
Escáner MEDIT T310			Accesorio (SET00000085)		El escáner MEDIT T310 está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).
Escáner MEDIT T510			Accesorio (SET00000086)		El escáner MEDIT T510 está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).
Escáner MEDIT T710			Accesorio (SET00000087)		El escáner MEDIT T710 está diseñado para ser utilizado por los profesionales del laboratorio odontológico como escáner 3D de modelos positivos y negativos (impresiones).

Piezas accesorias	DWOS /DWOS Easy	DWOS Chair side	N.º de pieza	Imagen	Uso previsto
Equipo (DWOS Chairside)	●		Accesorio (4000-1)		<p>PC para instalación de DWOS Chairside, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Equipo compacto de alto rendimiento ▪ Cable de alimentación específico para cada región
Equipo (DWOS)			Accesorio (019-2014)		<p>PC para instalación de DWOS, que incluye: - Equipo de alto rendimiento - Cable de alimentación específico para cada región</p>
Juego de accesorios (DWOS Chairside)	●		Accesorio (2201-2)		<p>Accesorios de PC para el equipo DWOS Chairside, entre los que se incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pantalla Full HD de 23" multitáctil ▪ Teclado con ratón específico para cada región ▪ Cables LAN y HDMI ▪ Cable de alimentación específico para cada región

8.5 Etiqueta

La etiqueta del producto está en el *cuadro Acerca de* del software. Aquí es donde debe buscarla:

DWOS

Pantalla de inicio de DWOS (tras iniciar sesión), esquina inferior derecha > **Acerca de DWOS**.




Figura 17: Etiqueta en DWOS

DWOS Easy

Ajustes > **Acerca de Easy**.




Figura 18: Etiqueta en DWOS Easy

DWOS Chairside

En la pantalla de inicio de sesión, esquina inferior izquierda > **Acerca de DWOS Chairside.**












Figura 19: Etiqueta en DWOS Chairside

9. Explicación de los símbolos

	Indica el fabricante legal
	Indica la fecha de fabricación
	Indica el número de artículo del dispositivo
	Precaución: Consulte las Instrucciones de uso, en las que se incluye información importante sobre precauciones
	Consulte las Instrucciones de uso
	Consulte las Instrucciones de uso (en dispositivos médicos: <i>Respete las instrucciones de uso</i>)
	El dispositivo cumple los requisitos de las directivas europeas indicadas en la declaración UE de conformidad
	Precaución: La ley federal de EE. UU. indica que este dispositivo solo pueden venderlo profesionales de la salud con la debida licencia. También puede venderse por orden de dichos profesionales.
	No deseche este dispositivo junto con los residuos municipales sin clasificar. La recogida debe efectuarse por separado.

www.dentalwings.com



DENTAL WINGS inc.

160 Rue St-Viateur E
Montreal QC H2T 1A8
CANADÁ

T +1 514 807-8485 (Internacional)

T +1 888 856-6997 (Norteamérica)

F +1 514 223-3981

Software DWOS **Instrucciones de uso**
v.3.0-ES

Sello del distribuidor